


CARTA DE TRAZABILIDAD LABORATORIO DE METROLOGÍA EN TIEMPO Y FRECUENCIA

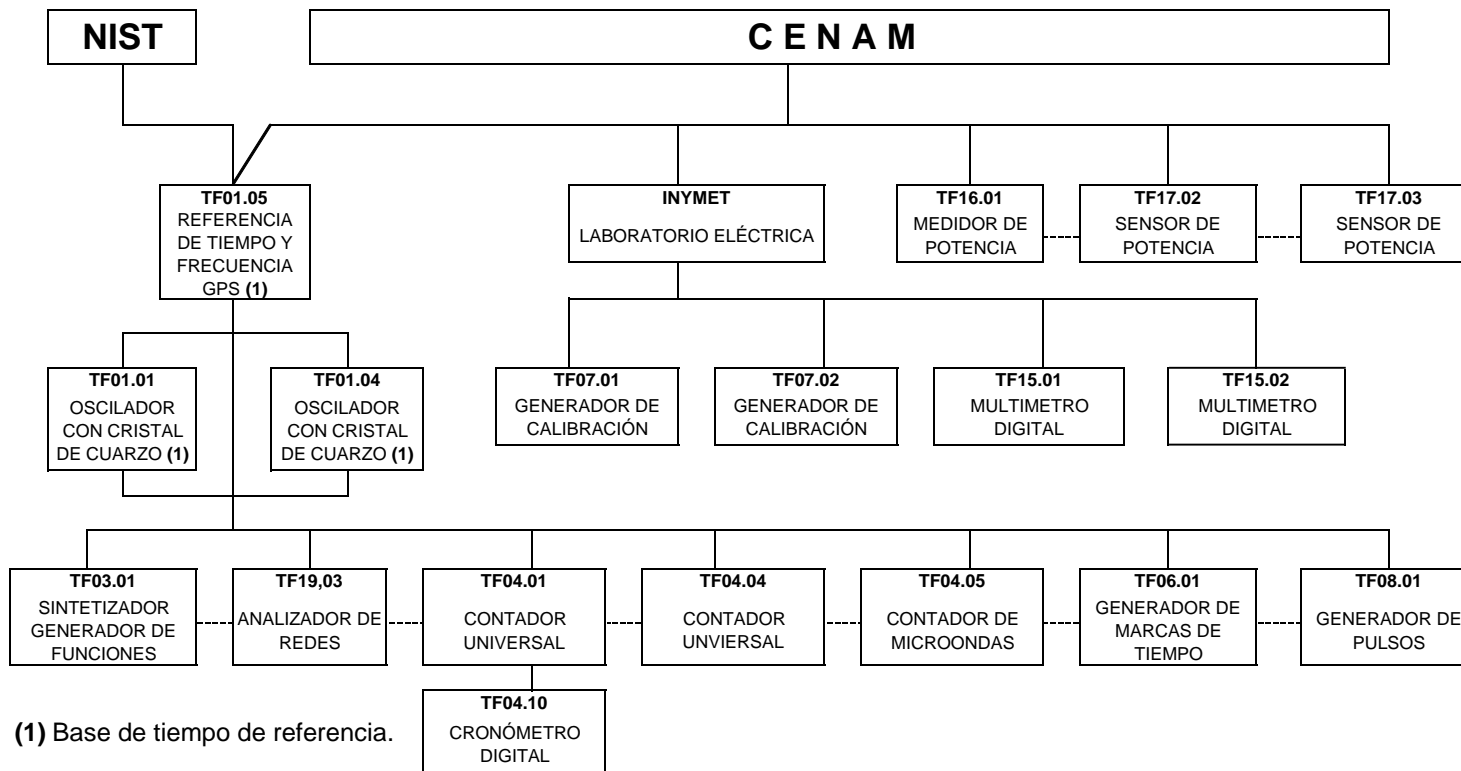

CARTA DE TRAZABILIDAD
LABORATORIO DE METROLOGÍA EN TIEMPO Y FRECUENCIA

IDENT.	INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE N°	CALIBRADO	INFORME	CALIBRA	TRAZABILIDAD	PROX. CAL.
TF01.01	OSCILADOR CON CRISTAL DE CUARZO	Hewlett Packard	10544A	2016A14064	01-Feb-2005	IMF-0051-2005	INYMET, S.A.	CENAM	01-Feb-2006
TF01.05	REFERENCIA DE TIEMPO Y FRECUENCIA GP	Hewlett Packard	58503A	3504A00226	02-Abr-2004	CNM-CC-430-011/2004	CENAM	CENAM / NIST	02-Abr-2006
TF03.01	SINTETIZADOR GENERADOR DE FUNCIONES	Hewlett Packard	3325A	1748A14858	17-Mar-2005	IMF-0137-2005	INYMET, S.A.	CENAM	17-Mar-2006 (1)
TF03.07	GENERADOR DE SEÑAL SINTETIZADA	Hewlett Packard	8673B	2525A00729	22-Dic-2004	IMF-0809-2004	INYMET, S.A.	CENAM	22-Dic-2005 (1)
TF04.01	CONTADOR UNIVERSAL	Hewlett Packard	5335A	2838A12449	17-Mar-2005	IMF-0138-2005	INYMET, S.A.	CENAM	17-Mar-2006 (1)
TF04.04	CONTADOR UNIVERSAL	Hewlett Packard	5345A	2514A11647	29-Jun-2005	IMF-0387-2005	INYMET, S.A.	CENAM	29-Jun-2006 (1)
TF04.05	CONTADOR DE FRECUENCIA	Hewlett Packard	5351B	304901808	22-Dic-2004	IMF-0810-2004	INYMET, S.A.	CENAM	22-Dic-2005 (1)
TF04.06	CONTADOR UNIVERSAL	Hewlett Packard	5334B	2839A03610	18-Mar-2005	IMF-0140-2005	INYMET, S.A.	CENAM	18-Mar-2006 (1)
TF04.10	CRONÓMETRO DIGITAL	Casio	HS-50W	Sin Serie	02-Dic-2004	IMF-0776-2004	INYMET, S.A.	CENAM	02-Dic-2005
TF06.01	GENERADOR DE MARCAS DE TIEMPO	Tektronix	TG 501	B049273	17-Mar-2005	IMF-0139-2005	INYMET, S.A.	CENAM	17-Mar-2006 (1)
TF07.02	GENERADOR DE CALIBRACION	Tektronix	CG 5011	B010913	30-May-2005	IMF-0303-2005	INYMET, S.A.	CENAM	30-May-2006
TF09.03	OSCILOSCOPIO DIGITAL	Tektronix	2430A	B023214	23-Nov-2004	IMF-0744-2004	INYMET, S.A.	CENAM	23-Nov-2005
TF15.01	MULTIMETRO DIGITAL	FLUKE	8506A	4095023	17-May-2005	IME-0227-2005	INYMET, S.A.	CENAM	17-May-2006
TF15.02	MULTIMETRO DIGITAL	FLUKE	8842A	5346286	21-Abr-2005	IME-0177-2005	INYMET, S.A.	CENAM	21-Abr-2006
TF16.03	MULTÍMETRO RMS VERDADERO	FLUKE	8921A	2106006	26-Dic-2004	IME-0678-2004	INYMET, S.A.	CENAM	27-Dic-2005
TF17.01	SENSOR DE POTENCIA	Hewlett Packard	11722A	3111A04397	07-Abr-2005	CNM-CC-410-091/2005	CENAM	CENAM	07-Abr-2007
TF17.02	SENSOR DE POTENCIA	Hewlett Packard	8481D	2928A01906	07-Sep-2004	CNM-CC-410-329/2004	CENAM	CENAM	07-Sep-2005
TF17.03	SENSOR DE POTENCIA	Hewlett Packard	8482A	2652A20467	01-Abr-2005	CNM-CC-410-090/2005	CENAM	CENAM	01-Abr-2007
TF18.01	CALIBRADOR MULTIFUNCIONES	Fluke	5100B	4110004	11-Sep-2004	IME-0493-2004	INYMET, S.A.	CENAM	11-Sep-2005
TF19.01	ANALIZADOR DE MODULACIÓN	Hewlett Packard	8901B	3403A04652	07-Abr-2005	CNM-CC-410-092/2005	CENAM	CENAM	07-Abr-2007
TF19.03	ANALIZADOR DE REDES	Hewlett Packard	8753D	3410A05863	29-Abr-2005	IMF-0222-2005	INYMET, S.A.	CENAM	29-Abr-2006 (1)
TF20.01	MEDIDOR DE POTENCIA OPTICA	Wandel & Golterm	OLP-25	AZ-0038	03-Sep-2004	CNM-CC-520-121/2004	CENAM	CENAM	03-Sep-2005
TF20.02	ATENUADOR OPTICO	Wandel & Golterm	OLA-25	AP-0050	NO APLICA	NO APLICA	CENAM	CENAM	NO APLICA
TF20.03	FUENTE LASER	WANDEL & GOLT	OLS-25	AS-0008	NO APLICA	NO APLICA	CENAM	CENAM	NO APLICA
TF22.02	CALIBRADOR DE INTERVALO	Hewlett Packard	11683A	3042A04402	21-Jul-2005	IME-0178-2005	INYMET, S.A.	CENAM	21-Jul-2006

Notas: (1) BASE DE TIEMPO DE REFERENCIA: TF01.04 o TF01.05